ogy Co.,Ltd
el:
BYTES
贝源检测
广东贝源检测技术股份有限公司
20171
1116
013

检 报

（
字 201
贝
环境检测 9）

委托方
类别
日期
日:
10

测技章股份
(盖
广东贝源检测技术
Guangdong Bytest
股份有
Technol
限公司

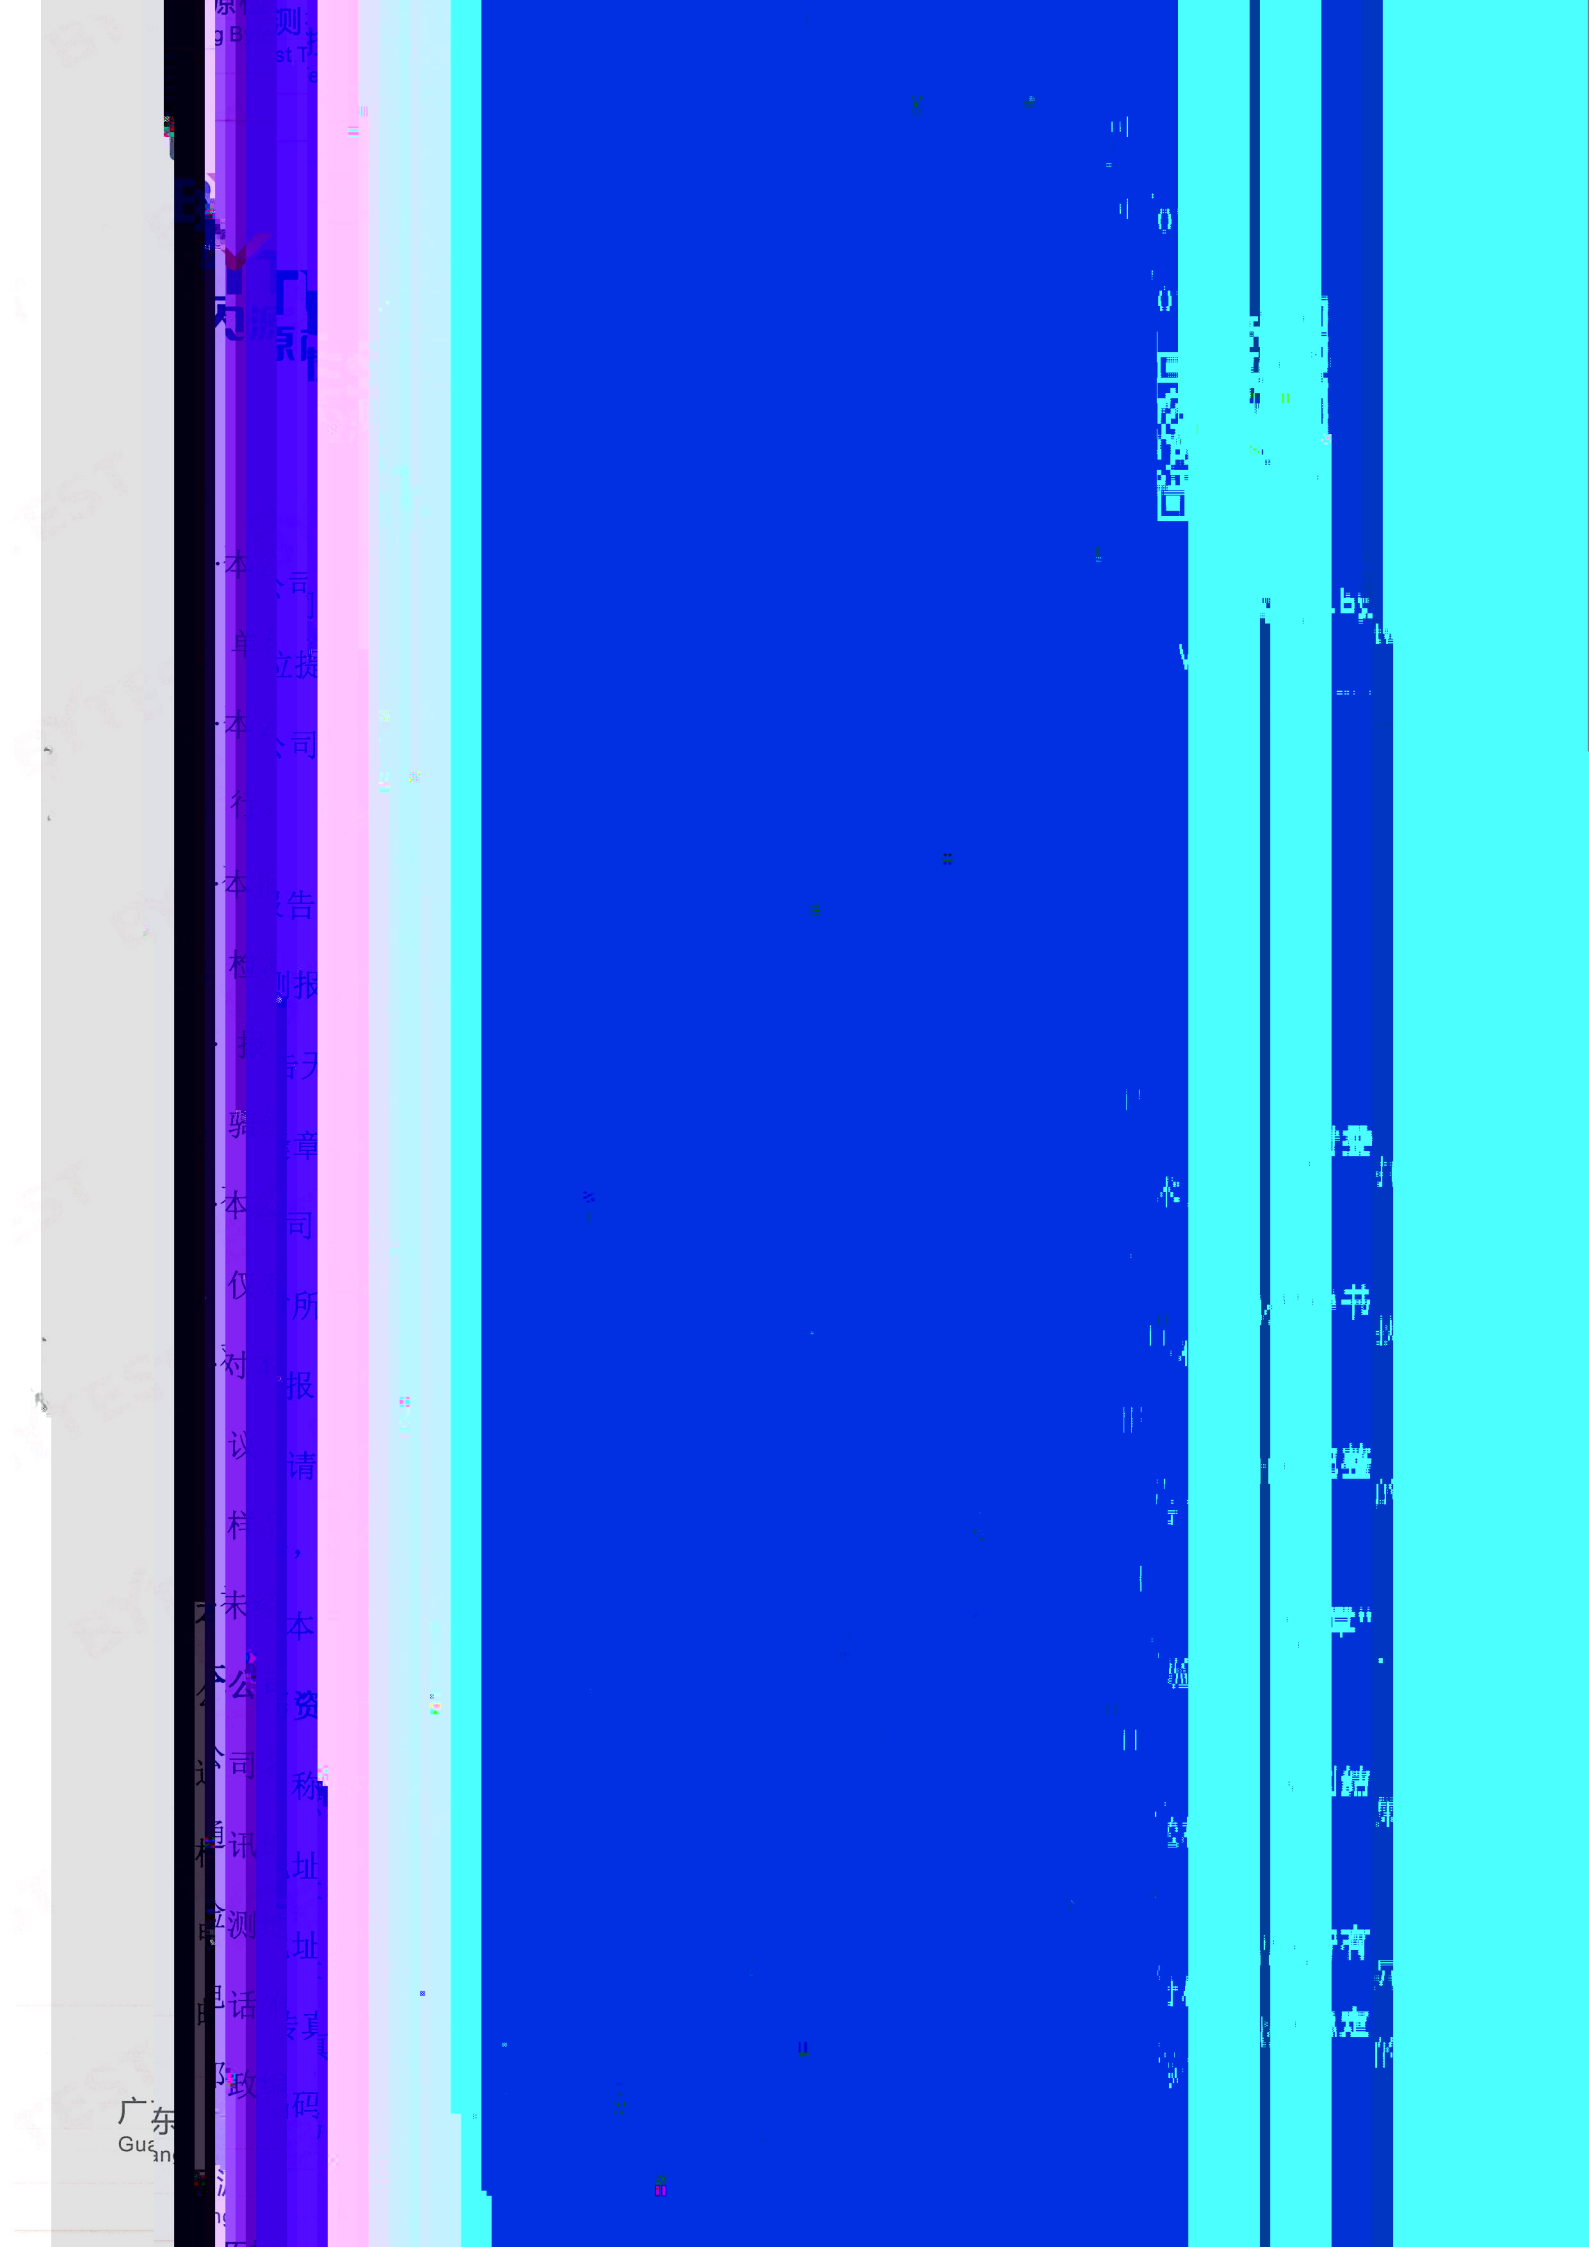

编写：

签名：

审核：

签名：

签发：

签名：

职务：

时间：

分所人

收件日

分所日

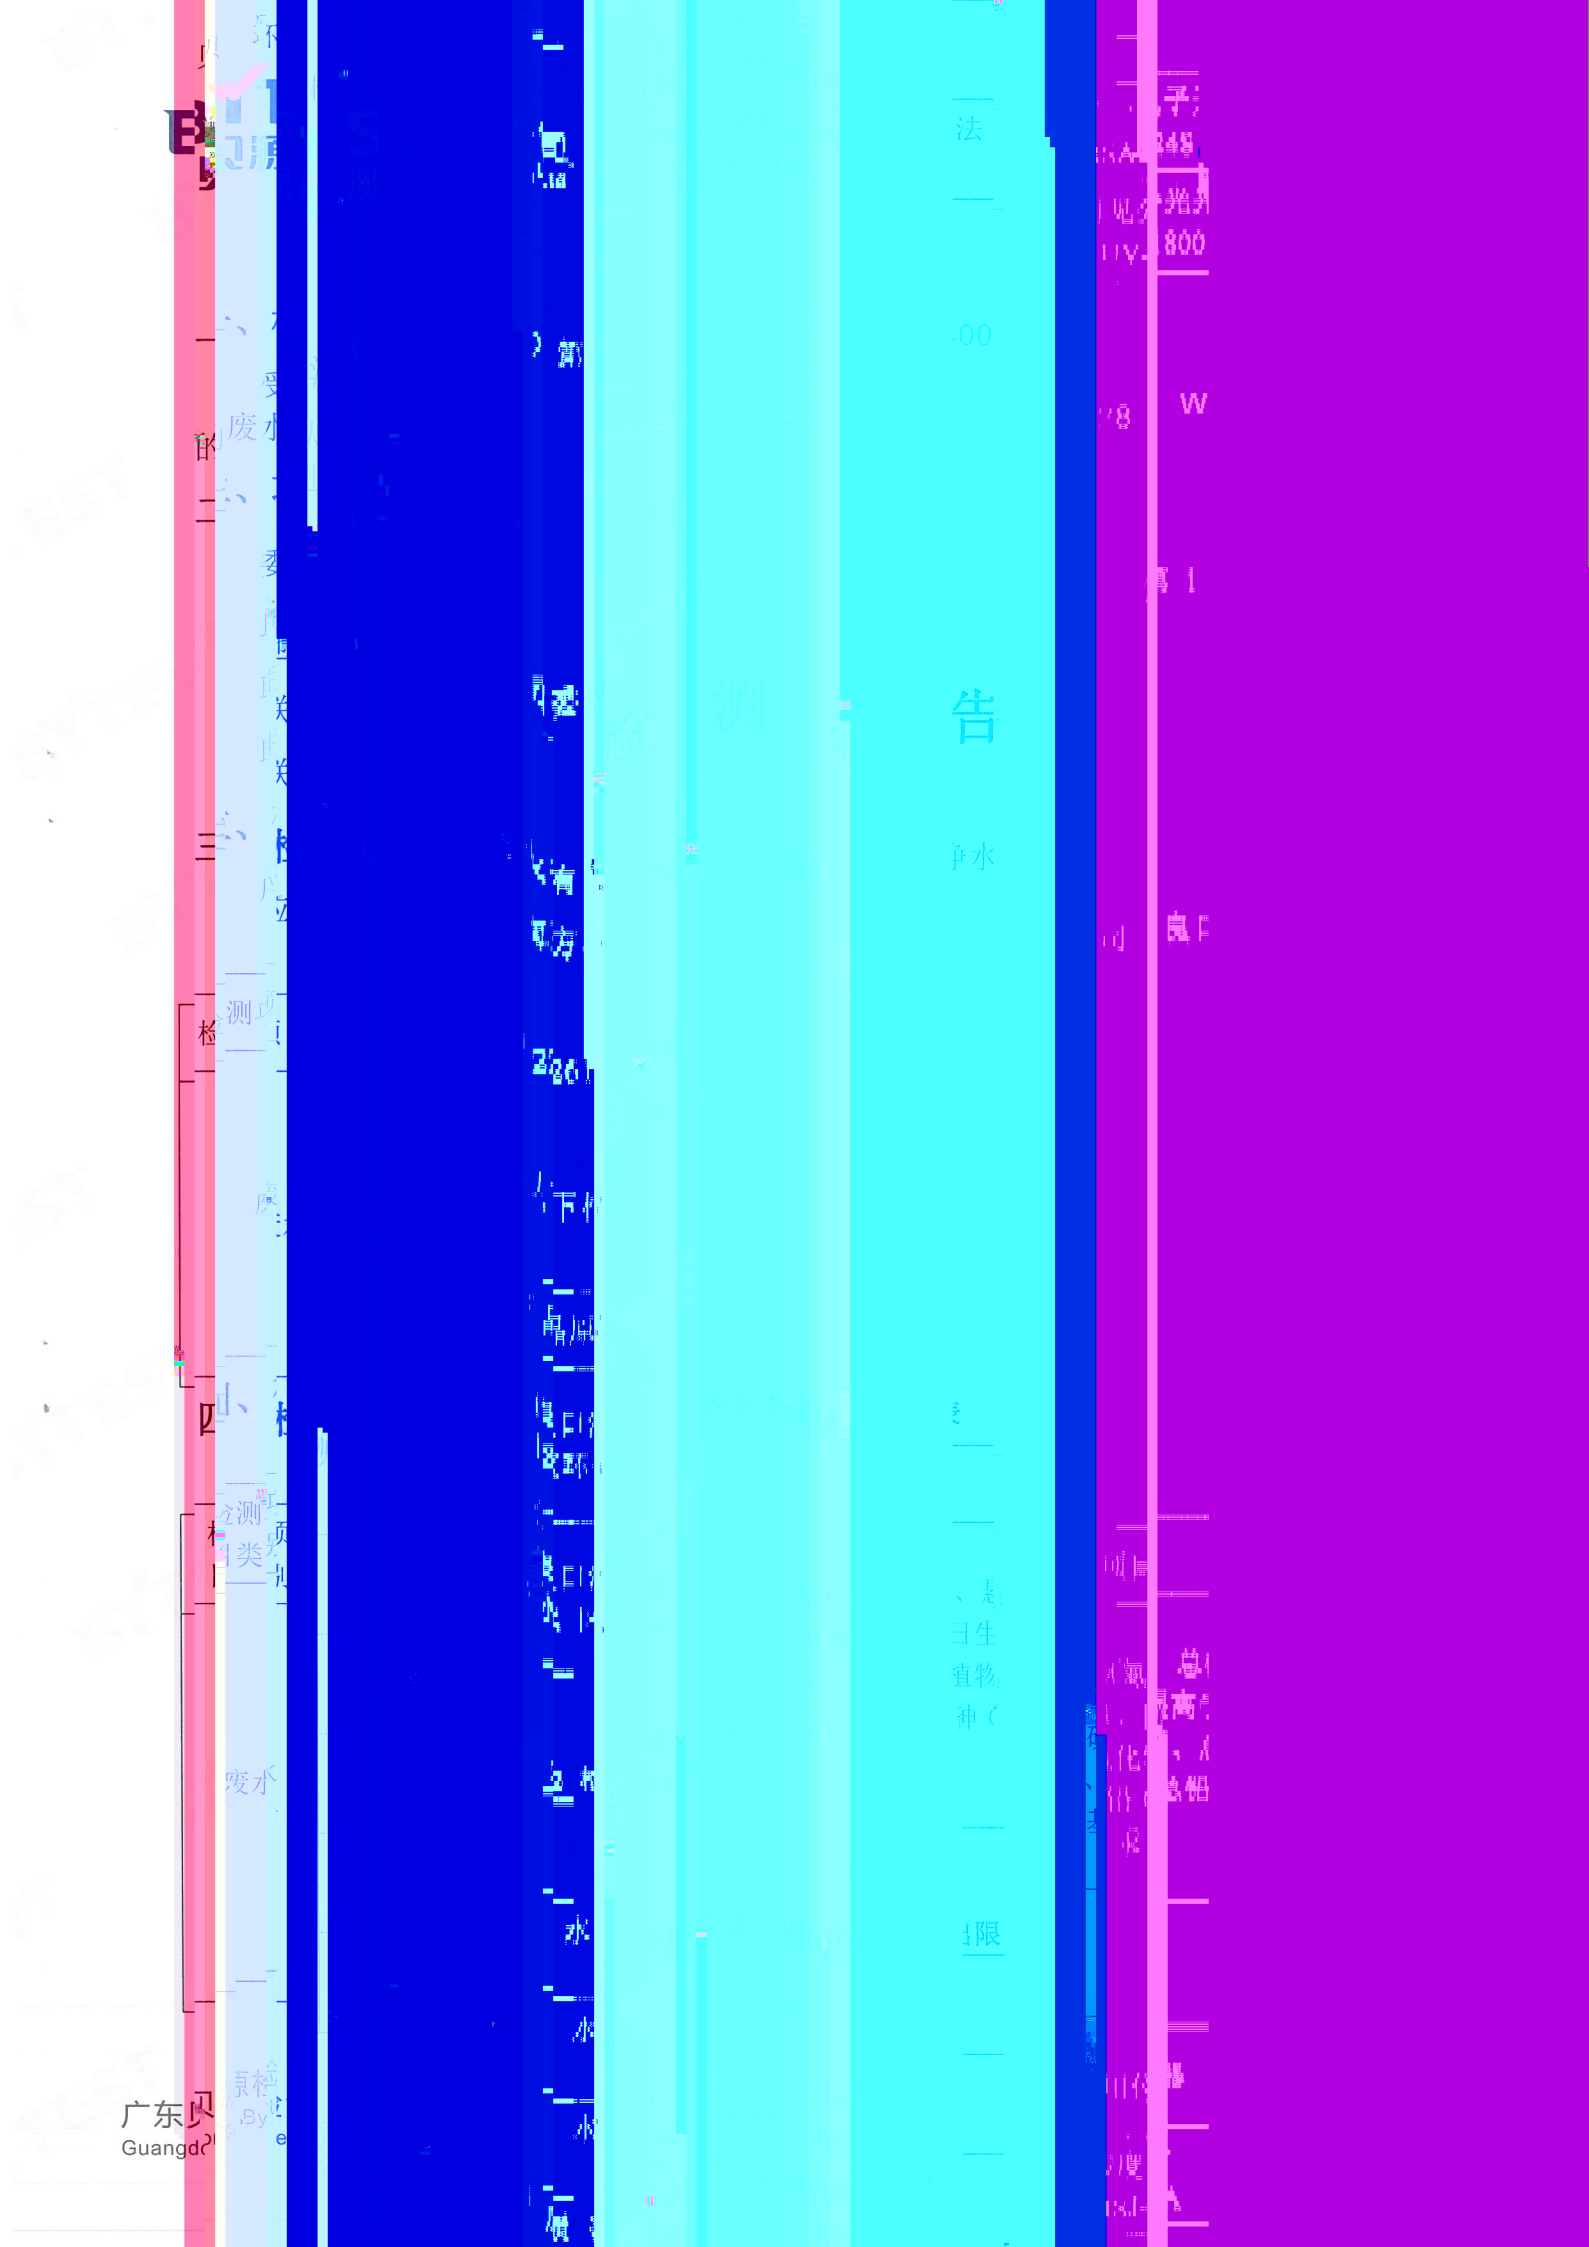
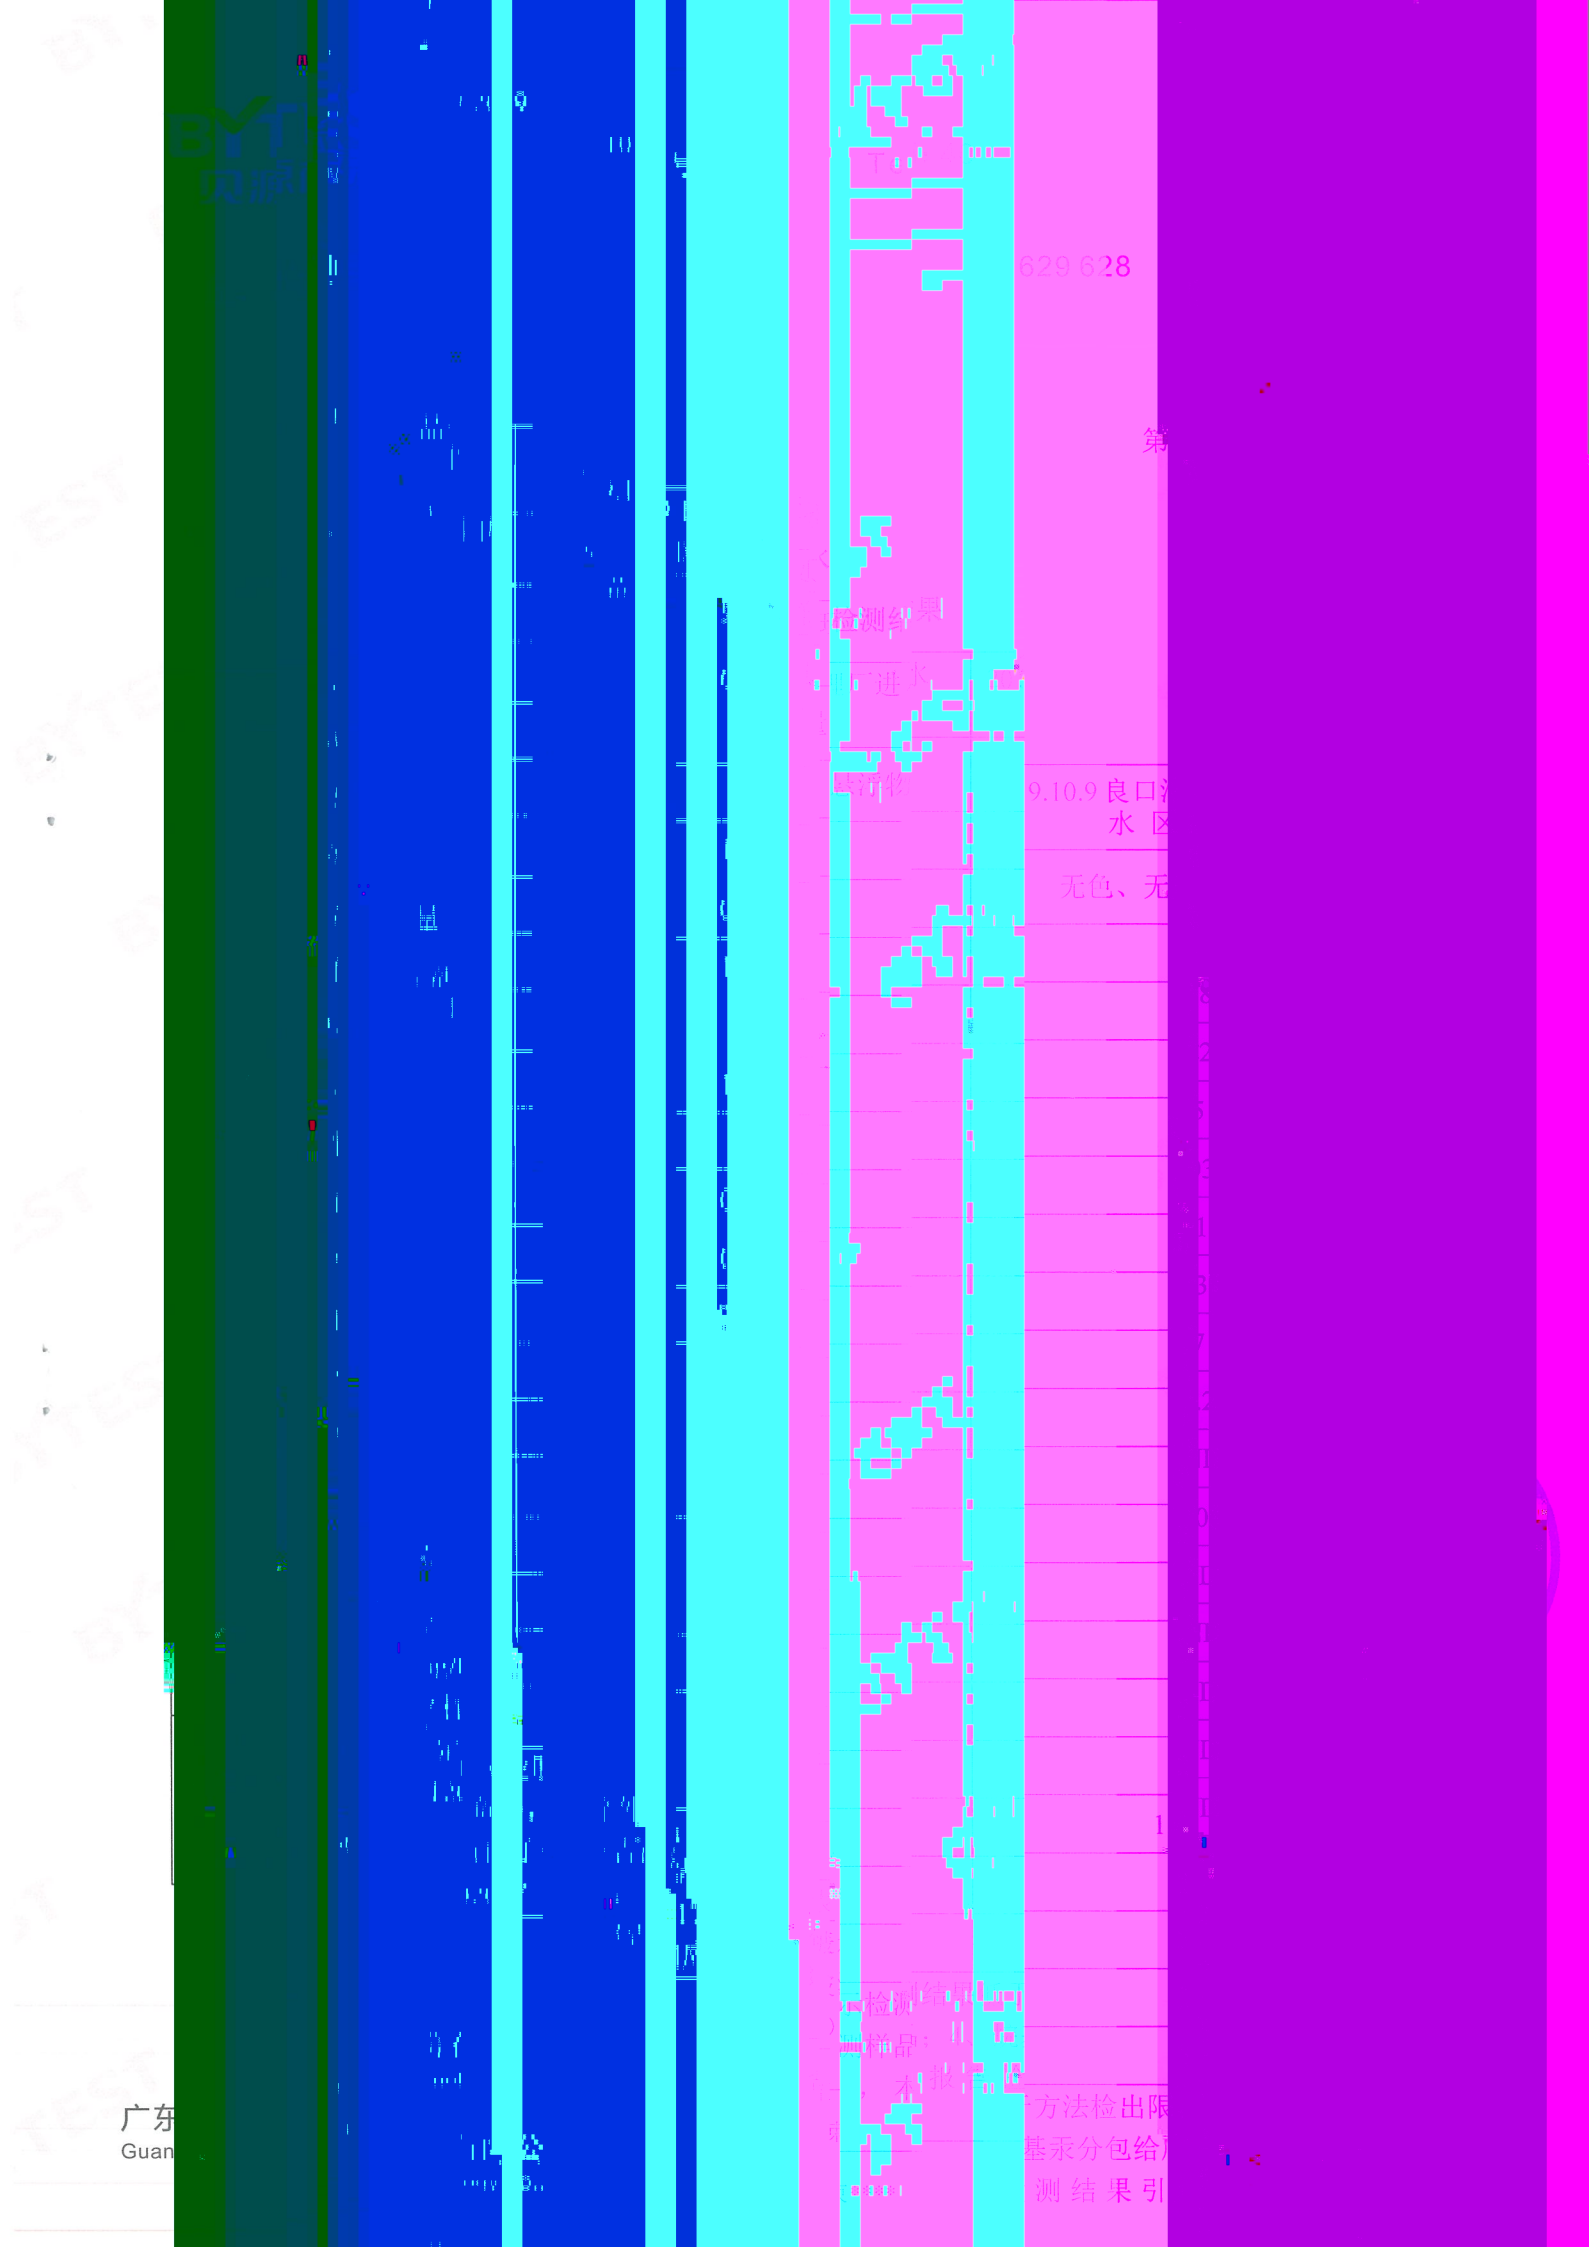
使用仪器	检出限
紫外可见分光光度计 UV-1800	0.025mg/L
紫外可见分光光度计 UV-1800	0.5mg/L
生化培养箱 SPX-250A	0.5mg/L
紫外可见分光光度计 SP-752	0.01mg/L
原子荧光光度计 AFS-9230	0.04μg/L
紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
原子荧光光度计 AFS-2000	0.00004mg/L
原子荧光光度计 AFS-2000	0.0004mg/L
离子色谱仪 ECL	1.0×10⁻³mg/L
离子色谱仪 ECL	2.0×10⁻³mg/L